

**Publication number:** EP1127546 (A2)  
**Publication date:** 2001-08-29  
**Inventor(s):** HARDING GEOFFREY PROF DR [DE]  
**Applicant(s):** PHILIPS CORP INTELLECTUAL PTY [DE];  
 KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]  
**Classification:**  
 - **international:** G01N23/04; A61B6/03; G01N23/20; G01T7/00;  
 G21K1/04; G01N23/02; A61B6/03; G01N23/20;  
 G01T7/00; G21K1/02; (IPC1-7): A61B6/03  
 - **European:** A61B6/06; A61B6/02H; A61B6/03B4  
**Application number:** EP20010200652 20010222  
**Priority number(s):** DE20001009285 20000228

**Also published as:**


EP1127546 (A3)  
 EP1127546 (B1)  
 US6470067 (B1)  
 JP2001269331  
 (A)  
 DE10009285  
 (A1)

**Cited documents:**

US4149247 (A)  
 US4751722 (A)  
 WO9945843 (A1)  
 US4384209 (A)  
 US3937965 (A)

[View INPADOC patent family](#)

[View list of citing documents](#)

[View document in the European Register](#) 

[Report a data error here](#)

**Abstract of EP 1127546 (A2)**

A circular gantry rotating about the object (13) investigated carries an X-ray source (S) projecting a fan shaped beam (41) partly through the object and partly directly onto a two dimensional matrix detector (16). A collimator (6) in front of the detector has lamella (60) which divide the beam into sections so that a detector column is targeted only by one or other of the two parts of the beam from the same section

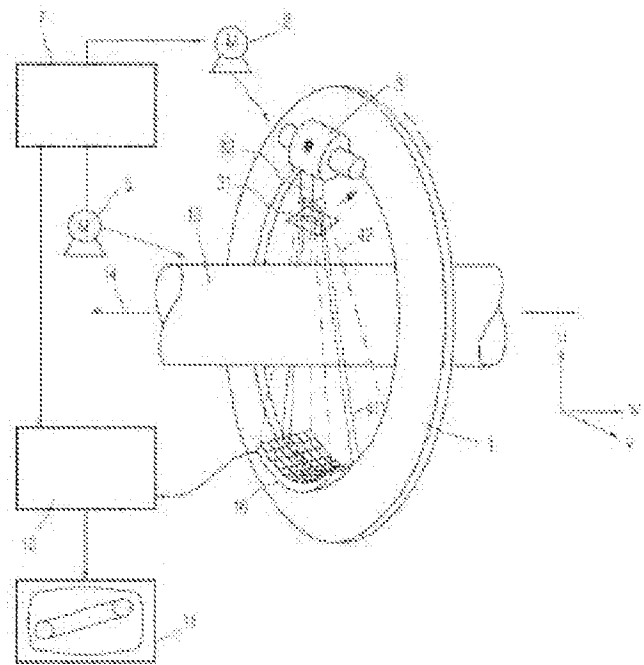


FIG. 1



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**29.08.2001 Patentblatt 2001/35**

(51) Int Cl.<sup>7</sup>: **A61B 6/03**

(21) Anmeldenummer: **01200652.4**

(22) Anmeldetag: **22.02.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: **28.02.2000 DE 10009285**

(71) Anmelder:  


- **Philips Corporate Intellectual Property GmbH**  
**52064 Aachen (DE)**  
Benannte Vertragsstaaten:  
**DE**
- **Koninklijke Philips Electronics N.V.**  
**5621 BA Eindhoven (NL)**  
Benannte Vertragsstaaten:  
**FR GB NL**

(72) Erfinder: **Harding, Geoffrey, Prof. Dr.**  
**Habsburgerallee 11, 52064 Aachen (DE)**

(74) Vertreter: **Gössmann, Klemens et al**  
**Philips Corporate Intellectual**  
**Property GmbH**  
**Habsburgerallee 11**  
**52064 Aachen (DE)**

(54) **Computertomograph zur Ermittlung des Impulsübertragspektrums in einem Untersuchungsbereich**

(57) Die Erfindung betrifft einen Computertomographen mit einer Abtasteinheit, die relativ zu einem Untersuchungsbereich um eine durch den Untersuchungsbereich verlaufende Rotationsachse drehbar ist und die eine Strahlenquelle zur Erzeugung eines Strahlenbündels, eine zwischen der Strahlenquelle und dem Untersuchungsbereich befindliche Blenden-Anordnung zur Erzeugung eines den Untersuchungsbereich durchsetzenden Strahlenfächers aus dem Strahlenbündel und eine zweidimensionale, eine Vielzahl von Detektorelementen umfassende Detektor-Anordnung umfasst, die mit einem Teil ihrer Messfläche Primärstrahlung aus dem Strahlenfächer und mit einem anderen Teil ihrer Messfläche in dem Untersuchungsbereich erzeugte Streustrahlung erfasst. Dabei wird eine einwandfreie Akquisition des Impulsübertragsspektrums dadurch erreicht, dass zwischen dem Untersuchungsbereich und der Detektor-Anordnung eine Kollimator-Anordnung mit einer Vielzahl von Lamellen angeordnet ist, die in sich vorzugsweise im Fokus der Strahlenquelle schneidenden Ebenen liegen, die den Strahlenfächer in eine Anzahl von Abschnitten unterteilen, so dass die in einer zur Rotationsachse parallelen Spalte befindlichen Detektorelemente von Primär- bzw. Streustrahlung aus dem gleichen Abschnitt getroffen werden.

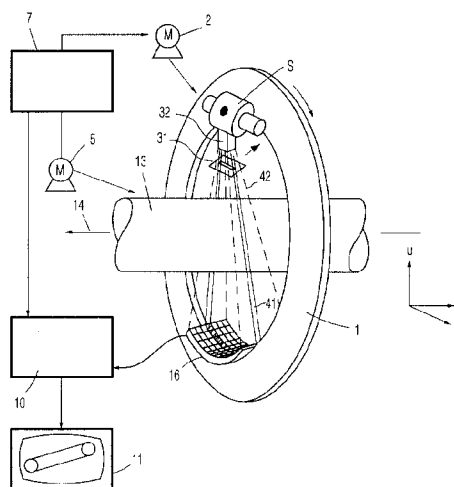

**FIG. 1**

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft einen Computertomographen mit einer Abtasteinheit, die relativ zu einem Untersuchungsbereich um eine durch den Untersuchungsbereich verlaufende Rotationsachse drehbar ist und die eine Strahlenquelle zur Erzeugung eines Strahlenbündels, eine zwischen der Strahlenquelle und dem Untersuchungsbereich befindliche Blenden-Anordnung zur Erzeugung eines den Untersuchungsbereich durchsetzenden Strahlenfächers aus dem Strahlenbündel und eine zweidimensionale, eine Vielzahl von Detektorelementen umfassende Detektor-Anordnung umfasst, die mit einem Teil ihrer Messfläche Primärstrahlung aus dem Strahlenfächer und mit einem anderen Teil ihrer Messfläche in dem Untersuchungsbereich erzeugte Streustrahlung erfasst.

**[0002]** In einer Veröffentlichung von J.A. Grant et al "A RECONSTRUCTION STRATEGY SUITED TO X-RAY DIFFRACTION TOMOGRAPHY" Am.J.Optics A 12, 291-300, im folgenden auch kurz als D1 bezeichnet, ist ein Computertomographie-Verfahren bekannt, bei dem der Untersuchungsbereich entlang einer Vielzahl paralleler Strahlenpfade und aus einer Vielzahl von Richtungen mit einem bleistiftförmigen Röntgenstrahl (pencil beam) durchstrahlt wird. Die Detektor-Anordnung jenseits des Untersuchungsbereichs erfasst dabei nicht nur den (geschwächten) Primärstrahl, sondern auch die elastisch gestreute Röntgenstrahlung. Elastisch bzw. kohärent gestreute Röntgenstrahlung entsteht bekanntlich, wenn die Röntgenquanten bei dem Streuprozess keine Energie verlieren, während die mit einem Energieverlust verbundene Form der Streuung als Compton-Streuung bezeichnet wird. Die elastische Streuung dominiert bei kleinen Streuwinkeln (z.B.  $< 10^\circ$ ), während die Compton-Streuung bei den größeren Streuwinkeln überwiegt. Im Gegensatz zu der Compton-Streustrahlung erlaubt die elastisch gestreute Strahlung eine Charakterisierung der im Untersuchungsbereich befindlichen Materie.

**[0003]** Diejenigen Detektorelemente, die der Primärstrahlung nicht direkt ausgesetzt sind, werden von Streustrahlung getroffen, die entlang des jeweiligen Primärstrahls im gesamten Untersuchungsobjekt entsteht. Der Impulsübertrag (englisch: momentum transfer), der dem Produkt aus der Energie der gestreuten Quanten und dem Sinus des halben Streuwinkels proportional ist, lässt sich dabei mit Hilfe einer iterativen algebraischen Rekonstruktionstechnik (ART) rekonstruieren, das im einzelnen in D1 beschrieben ist. Als Ergebnis der Rekonstruktion wird für jedes Voxel im Untersuchungsbereich der von einem Primärstrahl durchsetzt wird, ein Impulsübertragsspektrum (das Impulsübertragsspektrum stellt die Intensität der Streustrahlung als Funktion des Impulsübertrages dar) erhalten, das für die Materie in dem betreffenden Voxel charakteristisch ist und somit Rückschlüsse über die stoffliche Zusammensetzung zulässt.

**[0004]** Ein in D1 bereits angesprochener Nachteil dieses Verfahrens besteht in der relativ langen Messzeit für die Akquisition sämtlicher für die Rekonstruktion erforderlicher Messdaten. In D1 ist angegeben, dass sich diese Messzeit durch einen Computertomographen z. B. mit einer Fächerstrahl-Geometrie verkürzen lässt, dass die Messdaten aber dann stärker durch unerwünschte Streustrahlung korumpiert sind. Diesen Nachteil hat das aus der WO 99/45843 bekannte Verfahren. Jedes Detektorelement kann dabei Streustrahlung aus dem gesamten Streustrahlenfächer empfangen, also auch solche Streustrahlung, die unter einem relativ großen Streuwinkel gestreut wird - überwiegend also Compton-Streustrahlung, die keine Aussage über die stoffliche Zusammensetzung des Untersuchungsbereichs zulässt. Außerdem ist kein Rekonstruktionsverfahren bekannt, das unter solchen Voraussetzungen die Rekonstruktion der Streudichte im Untersuchungsbereich gestatten würde.

**[0005]** Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen Computertomographen so auszugestalten, dass sich einerseits kurze Akquisitionszeiten und andererseits eine einwandfreie Rekonstruktion des Impulsübertragsspektrums im Untersuchungsbereich ergibt. Ausgehend von einem Computertomographen der eingangs genannten Art wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass zwischen dem Untersuchungsbereich und der Detektor-Anordnung eine Kollimator-Anordnung mit einer Vielzahl von Lamellen angeordnet ist, die in Ebenen liegen, die den Strahlenfächer in eine Anzahl von Abschnitten unterteilen, so dass die in einer zur Rotationsachse parallelen Spalte befindlichen Detektorelemente von Primär- bzw. Streustrahlung aus dem gleichen Abschnitt getroffen werden. Die Kollimator-Anordnung hat bei der Erfindung eine Doppelfunktion:

a) Sie verhindert, dass unter einem größeren Streuwinkel gestreute Streustrahlung überwiegend also Compton-Streustrahlung - auf die Detektorelemente trifft.

b) Sie unterteilt den Strahlenfächer in eine Anzahl von Abschnitten, die näherungsweise als "pencil beam" anzusehen sind, so dass die Impulsübertragsspektren für die verschiedenen Voxel im Untersuchungsbereich nach dem aus D1 bekannten Verfahren rekonstruiert werden können.

**[0006]** Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die parallel zur Rotationsachse bzw. senkrecht zum Strahlenfächer verlaufenden Lamellen der Kollimator-Anordnung anordnen kann. Anspruch 2 gibt die bevorzugte Anordnung an.

**[0007]** Die weitere Ausgestaltung gemäß Anspruch 3 macht es möglich, mit geringem zusätzlichen Aufwand einen Computertomographen einerseits zur Ermittlung der Impulsübertragsspektren der Streustrahlung und andererseits zur Ermittlung der Schwächung der Rönt-

genstrahlung -mit noch weiter verkürzter Akquisitionszeit (cone beam CT) - zu benutzen. Die weitere Ausgestaltung nach Anspruch 4 beschreibt den dafür nötigen Übergang von einem Strahlenfächer auf einen Strahlenkonus. Anspruch 5 erläutert die Verarbeitung der in den verschiedenen Betriebsmodi gewonnenen unterschiedlichen Messdaten.

**[0008]** Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen:

- Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Computertomographen in schematischer Darstellung.
- Fig. 2 einen Querschnitt durch die Anordnung nach Fig. 1,
- Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Spalte von detektorelementen und
- Fig. 4 ein Ablaufdiagramm zur Erläuterung der verschiedenen Betriebsmodi.

**[0009]** Der in Fig. 1 dargestellte Computertomograph umfasst eine Gantry 1, die um eine Rotationsachse 14 rotieren kann. Dazu wird die Gantry 1 von einem Motor 2 angetrieben. An der Gantry 1 ist eine Strahlenquelle S befestigt, beispielsweise ein Röntgenstrahler. Das zur Untersuchung benutzte Strahlenbündel wird von einer ersten Blendenanordnung 31 und/oder einer zweiten Blendenanordnung 32 bestimmt. Wenn die erste Blendenanordnung 31 wirksam ist, ergibt sich der mit ausgezogenen Linien dargestellte Strahlenfächer, der senkrecht zur Rotationsachse 14 verläuft und in deren Richtung geringe Abmessungen (z.B. 1mm) hat. Ist hingegen nur die zweite Blendenvorrichtung 32 im Strahlengang wirksam, dann ergibt sich der mit gestrichelten Linien angedeutete Strahlenkonus 42, der in einer zur Rotationsachse 14 senkrechten Ebene die gleiche Form hat, wie der Strahlenfächer 41, der aber in Richtung der Rotationsachse 14 wesentlich größere Abmessungen hat.

**[0010]** Das Strahlenbündel 41 bzw. 42 durchdringt einen zylinderförmigen Untersuchungsbereich 13, in dem sich z.B. ein Patient auf einem Patientenlagerungstisch (beides nicht näher dargestellt) oder aber auch ein technisches Objekt befinden kann. Nach dem Durchdringen des Untersuchungsbereichs 13 trifft das Strahlenbündel 41 bzw. 42 auf eine an der Gantry 1 befestigte zweidimensionale Detektor-Anordnung 16, die eine Vielzahl von matrixförmig angeordneten Detektorelementen umfasst. Die Detektorelemente sind in Zeilen und Spalten angeordnet. Die Detektorspalten verlaufen parallel zur Rotationsachse, die Detektorzeilen können sich in zur Rotationsachse senkrechten Ebenen befinden, beispielsweise auf einem Kreisbogen um die Strahlenquelle S. Die Detektorzeilen enthalten in der Regel wesentlich mehr Detektorelemente (z.B. 1000) als die Detektorspalten (z.B. 16).

**[0011]** Die Strahlenbündel 41 und 42, der Untersuchungsbereich 13 und die Detektor-Anordnung 16 sind

aneinander angepasst. In einer zur Rotationsachse senkrechten Ebene 14 sind die Abmessungen dieses Strahlenfächers 41 bzw. des Strahlenkonus 42 so gewählt, dass der Untersuchungsbereich 13 vollständig durchstrahlt wird, und die Länge der Zeilen der Detektor-Anordnung ist gerade so bemessen, dass die Strahlenbündel 41 bzw. 42 vollständig erfasst werden können. Der Strahlenkonus 42 ist entsprechend der Länge der Detektorspalten gewählt, so dass der Strahlenkonus vollständig von der Detektor-Anordnung 16 erfasst werden kann. Wenn lediglich der Strahlenfächer 41 den Untersuchungsbereich durchstrahlt, trifft er auf den bzw. auf die mittlere(n) Detektorzeile(n).

**[0012]** Wenn es sich um ein technisches Objekt handelt und nicht um einen Patienten, kann das Objekt bei einer Untersuchung gedreht werden, während die Strahlenquelle S und die Detektor-Anordnung 15 still stehen. Das Objekt kann mittels eines Motors auch parallel zur Rotationsachse 14 verschoben werden. Wenn die Motoren 5 und 2 gleichzeitig laufen, ergibt sich eine helixförmige Abtastbewegung der Strahlenquelle S und der Detektor-Anordnung 16.

**[0013]** Wie aus Fig. 2 ersichtlich, befindet sich zwischen dem Untersuchungsbereich 13 und der Detektor-Anordnung 16 eine Kollimator-Anordnung 6, die eine Vielzahl ebener Lamellen 60 umfasst. Die Lamellen bestehen aus einem die Röntgenstrahlung stark absorbierenden Material und liegen in Ebenen, die parallel zur Rotationsachse 14 verlaufen und sich im Fokus der Strahlenquelle S schneiden. Ihr Abstand voneinander kann z.B. 1 cm betragen, und jede Lamelle kann in der Zeichenebene eine Abmessung von z.B. 20 cm haben. Durch die Kollimator-Anordnung 6 wird also der Strahlenfächer 41 in eine Anzahl von einander benachbarten Abschnitten unterteilt, so dass eine Spalte von Detektorelementen im wesentlichen nur von Primär- bzw. Streustrahlung aus einem Abschnitt getroffen werden kann.

**[0014]** Die von der Detektoreinheit 16 auf der rotierenden Gantry 1 akquirierten Messdaten werden einem Bildverarbeitungsrechner 10 zugeführt, der sich in der Regel an einem festen Punkt im Raum befindet und mit der Detektoreinheit über einen kontaktlos arbeitenden, nicht näher dargestellten Datenschleifring verbunden ist. Der Bildverarbeitungsrechner 10 kann verschiedene Bildverarbeitungsoperationen durchführen.

**[0015]** Im folgenden sollen die verschiedenen mit dem dargestellten Computertomographen möglichen Betriebsmodi anhand des in Fig. 4 dargestellten Ablaufdiagramms erläutert werden.

**[0016]** Nach der Initialisierung im Block 100 erfolgt im Schritt 101 eine Wahl des Betriebsmodus. Wenn der erste Betriebsmodus (in dem die Streustrahlung ausgewertet wird) gewählt wird, verzweigt der Ablauf zum Schritt 102, in dem einerseits die erste Blendenanordnung 31 und andererseits die Kollimator-Anordnung 6 in den Strahlengang gefahren werden. Zur Akquisition der Messwerte im Schritt 103 wird daher der Strahlen-

fächer 41 erzeugt. Während der Akquisition rotiert die Gantry, so dass die Detektorelemente die Primärstrahlung bzw. die Streustrahlung aus einer Vielzahl von Winkelpositionen erfassen. Das oder die Detektorelemente in der Mitte einer jeden Detektorspalte erfassen die Primärstrahlung, während die Streustrahlung (Sekundärstrahlung) von den in einer Spalte weiter außen liegenden Detektorelementen erfasst wird.

**[0017]** Dies ist in Fig. 3 schematisch angedeutet, die eine Draufsicht auf eine Spalte von Detektorelementen darstellt. Die Detektorelemente 161, die die Streustrahlung erfassen, sind einfach schraffiert dargestellt, während das Detektorelement 160 (bzw. die Detektorelemente) im Zentrum, das die Primärstrahlung erfasst durch ein Kreuz markiert ist. Beiderseits dieses zentralen Detektorelementes befinden sich auf Grund der endlichen Abmessungen des Fokus der Strahlenquelle Detektorelemente, die von Streustrahlung aber auch von einer (reduzierten) Primärstrahlung getroffen werden. Es ist zweckmäßig die Signale dieser in der Zeichnung nicht schraffiert oder gekreuzt dargestellten Detektorelemente bei der Auswertung nicht zu berücksichtigen.

**[0018]** Der Impulsübertrag  $X$ , dessen Spektrum als Funktion des Ortes  $u, v$  rekonstruiert werden soll, ist bekanntlich dem Produkt aus der Energie der gestreuten Röntgenquanten und den Sinus des halben Streuwinkels proportional (der Streuwinkel ist der Winkel, den die Bahn des gestreuten Röntgenquants mit der Bahn einschließt, die das Röntgenquant ohne den Streuprozess genommen hätte). Die weiter außen liegenden Detektorelemente erfassen die Streustrahlung im Mittel unter einem größeren Streuwinkel als die weiter innen liegenden.

**[0019]** Um den Impulsübertrag bestimmen zu können, muss einerseits der Streuwinkel und andererseits die Energie des gestreuten Röntgenquants bekannt sein. Der Streuwinkel ist gegeben durch die Lage des Detektorelements und die Lage des Punktes in dem Primärstrahlenfächer, in den der Streuprozess stattgefunden hat. Die Energie der gestreuten Röntgenquanten muss entweder gemessen werden, was voraussetzt, dass die Detektorelemente Energie auflösend messen können, oder es muss Röntgenstrahlung mit Quantenenergien aus einem möglichst kleinen Bereich (im Idealfall monochromatische Röntgenstrahlung) verwendet werden. Um die Energiedifferenz  $\Delta E$  der Röntgenquanten möglichst klein in bezug auf ihre Energie  $E$  zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Der Gebrauch geeigneter Filtermaterialien (z.B. Kupfer) im Primärstrahl. Dadurch wird die von einem Röntgenstrahler erzeugte weiche Röntgenstrahlung (das ist Röntgenstrahlung mit niedriger Quantenenergie) weitgehend unterdrückt.
- Zusätzlich kann man bei einer Röntgenröhre die Spannung im Hinblick auf die Filterwahl optimieren.
- Schließlich ist es möglich, die sogenannte "balanced filter" Technik anzuwenden. Dabei werden die

Daten zweimal akquiriert, wobei sich im Strahlengang jeweils Filter mit leicht voneinander abweichender Ordnungszahl befinden, deren K-Kante zur Filterung herangezogen wird. Anschließend wird das Differenzsignal aus den beiden Messungen extrahiert.

**[0020]** Im abschließenden Schritt 104 wird das ortsabhängige Impulsübertragungsspektrum rekonstruiert. Da die Lamellen den Strahlenfächer in eine Anzahl von Abschnitten zerlegen, von denen jeder zumindestens näherungsweise die Form eines "pencil-beam" hat, kann die Rekonstruktion analog zu dem in D1 beschriebenen Verfahren erfolgen. Damit ist das Verfahren beendet (Block 105).

**[0021]** Wenn im Schritt 101 hingegen der zweite Betriebsmodus gewählt wird, in dem lediglich die Schwächung der Primärstrahlung im Untersuchungsbereich rekonstruiert wird, verzweigt der Ablauf zum Block 112, in dem die erste Blendenanordnung 31 aus dem Strahlengang gefahren wird, so dass nur noch die zweite Blendenanordnung 32 wirksam ist, die einen Strahlengkonus 42 erzeugt. Außerdem wird im Block 112 der Kollimator 6 aus dem Bereich zwischen der Detektoranordnung 16 und dem Untersuchungsbereich 13 entfernt.

**[0022]** Bei der danach beginnenden Akquisition der Messdaten rotiert die Gantry um die Rotationsachse, wobei sämtliche Detektorelemente von Primärstrahlung getroffen werden können (Block 113). Im anschließenden Rekonstruktionsschritt 114 wird die Schwächung in einer Scheibe des Untersuchungsbereichs rekonstruiert. Ein geeignetes Rekonstruktionsverfahren ist in der deutschen Patentanmeldung 198451334 (PHD 98-123) beschrieben.

## Patentansprüche

1. Computertomograph mit einer Abtasteinheit, die relativ zu einem Untersuchungsbereich (13) um eine durch den Untersuchungsbereich verlaufende Rotationsachse (14) drehbar ist und die eine Strahlenquelle (S) zur Erzeugung eines Strahlenbündels, eine zwischen der Strahlenquelle und dem Untersuchungsbereich befindliche Blenden-Anordnung (31,32) zur Erzeugung eines den Untersuchungsbereich durchsetzenden Strahlenfächers (41,42) aus dem Strahlenbündel und eine zweidimensionale, eine Vielzahl von Detektorelementen umfassende Detektor-Anordnung (16) umfasst, die mit einem Teil ihrer Messfläche Primärstrahlung aus dem Strahlenfächer und mit einem anderen Teil ihrer Messfläche in dem Untersuchungsbereich erzeugte Streustrahlung erfasst, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Untersuchungsbereich (13) und der Detektor-Anordnung (16) eine Kollimator-

Anordnung (6) mit einer Vielzahl von Lamellen angeordnet ist, die in Ebenen liegen, die den Strahlenfächer in eine Anzahl von Abschnitten unterteilen, so dass die in einer zur Rotationsachse parallelen Spalte befindlichen Detektorelemente im wesentlichen nur von Primär- bzw. Streustrahlung aus ein und demselben Abschnitt getroffen werden.

2. Computertomograph nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Ebenen, in denen die Lamellen liegen, sich im Fokus der Strahlenquelle schneiden.
3. Computertomograph nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
gekennzeichnet durch einen ersten Betriebsmodus, in dem ein Teil der Detektorelemente die Streustrahlung erfasst, die in dem Strahlenfächer erzeugt wird, und durch einen zweiten Betriebsmodus, in dem die Detektorelemente die Primärstrahlung erfassen, die in einem Strahlenkonus erzeugt werden, dessen Abmessungen in Richtung der Rotationsachse größer sind als die des Strahlenfächers.
4. Computertomograph nach Anspruch 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass zwischen der Strahlenquelle und dem Untersuchungsbereich im ersten Betriebsmodus eine erste Blenden-Anordnung zur Erzeugung des Strahlenfächers und im zweiten Betriebsmodus eine zweite Blenden-Anordnung zur Erzeugung des Strahlenkonus im Strahlengang wirksam ist.
5. Computertomograph nach Anspruch 3,  
gekennzeichnet durch  
ein erstes Computerprogramm zur Berechnung der Streudichtevertellung in dem vom Strahlenfächer durchsetzten Teil des Untersuchungsbereichs aus den im ersten Betriebsmodus akquirierten Detektor-Signalen und durch ein zweites Computerprogramm zur Berechnung der Schwächung der Primärstrahlung in dem vom Strahlenkonus durchsetzten Teil des Untersuchungsbereichs aus den im zweiten Betriebsmodus akquirierten Detektor-Signalen.

50

55

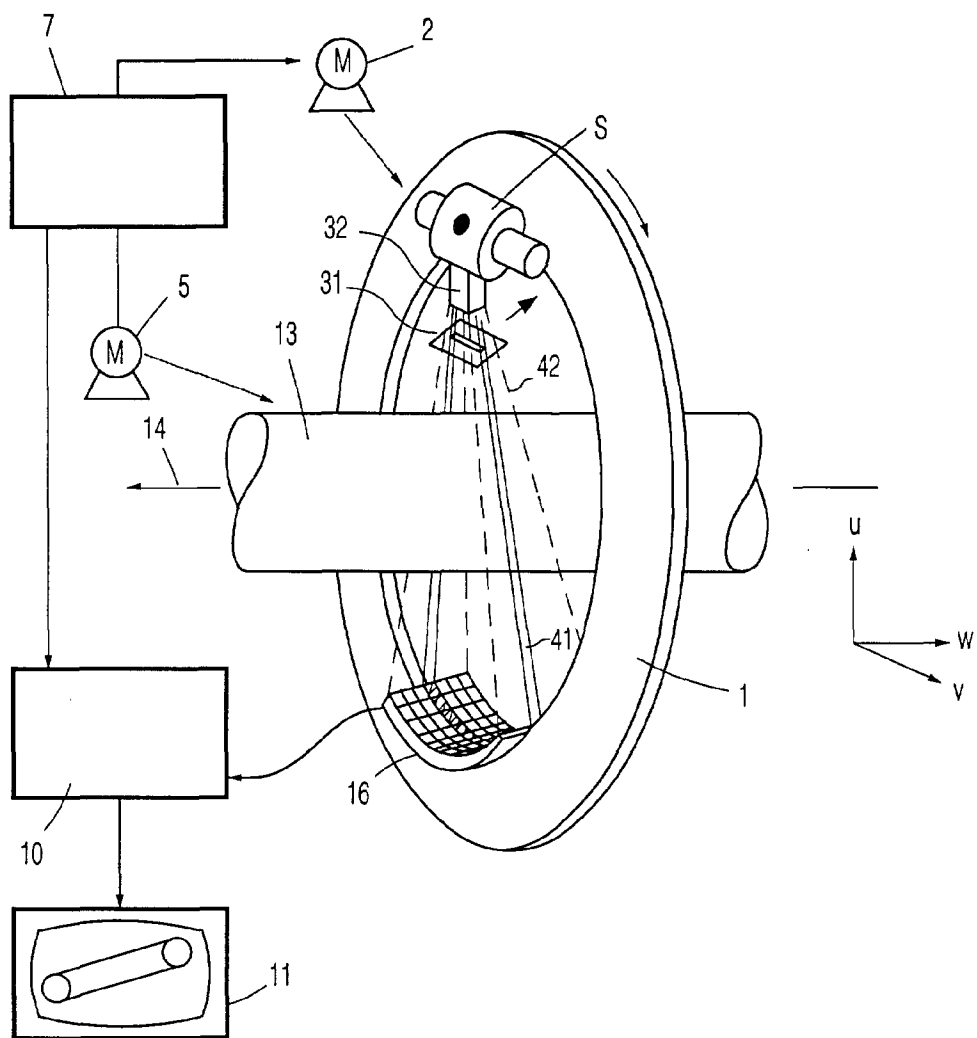


FIG. 1




FIG. 3

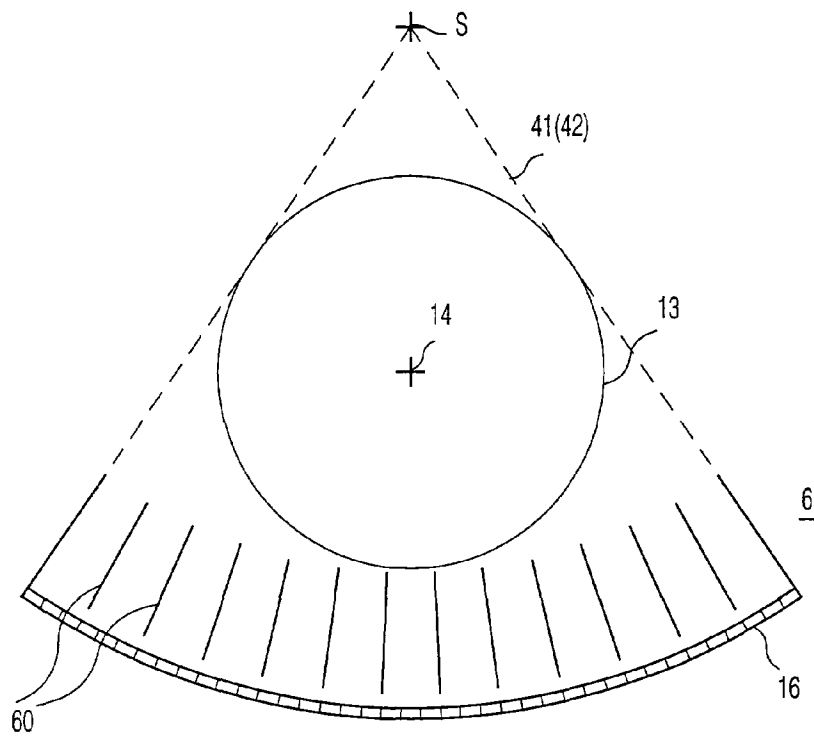


FIG. 2

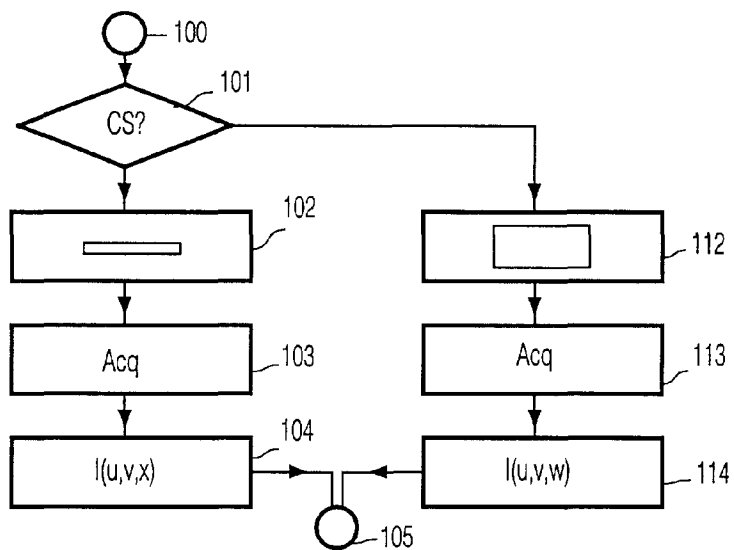


FIG. 4